


## Pomiar temperatury mieszaniny oziębiającej

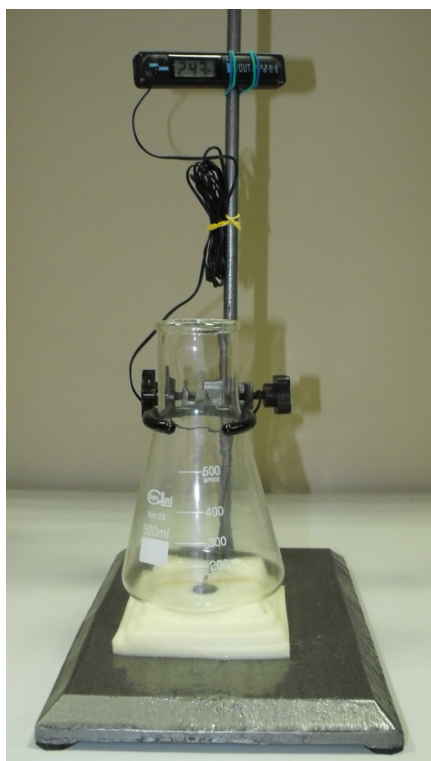

### Wyposażenie podstawowe:

- stojak laboratoryjny – 1 szt.
- zacisk laboratoryjny – 1 szt.
- uchwyt laboratoryjny – 1 szt.
- kolba szklana stożkowa ChemLand 500 [ml] – 1 szt.
- termometr elektroniczny – 1 szt.

### Procedura standardowego pomiaru:

1. .
- 2.
3. Po zakończeniu pomiaru stanowisko pozostawić w stanie, w jakim było przed rozpoczęciem ćwiczeń.